

## Эталонные модули давления Метран-518 (-Ex)



- **Диапазоны измерений:**
  - изб. давление от 0...0,4 кПа до 0...60 МПа;
  - новый диапазон 0-160 МПа;
  - абс. давление от 0...25 кПа до 0...6 МПа;
  - давление-разрежение;
    - от  $\pm 0,63$  кПа до  $-0,1...2,5$  МПа;
    - разрежение от 0...-0,630 до 0...-100 кПа
- Погрешность измерений  $\pm 0,02...0,1\%$  ВПИ
- Единицы измерения давления: Па, кПа, МПа, psi, кгс/м<sup>2</sup>, кгс/см<sup>2</sup>, мм рт.ст., мм вод.ст., мбар, бар
- Общепромышленное и взрывозащищенное с маркировкой (1ExialIBT4X), опция обезжиривания
- Степень защиты от пыли и воды IP54
- Аппаратно-программный интерфейс ПК (USB)
- Госреестр средств измерений № 39152-12
- ТУ 4381-061-51453097-2010
- ЕАС ТС N RU Д-РУ.АД07.В.01922
- ЕАС ТС RU С-РУ.АА87.В.00289/19

Эталонный модуль давления предназначен для точного измерения и непрерывного преобразования значений абсолютного и избыточного давления, разрежения, давления-разрежения при поверке и калибровке различных приборов давления, погрешность которых  $\pm 0,065\%$  и более.

Модуль давления Метран-518 может применяться в качестве:

- цифрового манометра при подключении к компьютеру через адаптер USB. Управление работой модуля, регистрация показаний и формирование протоколов поверки производится с помощью ПО «Поверка СИД»;
- рабочего эталона давления в составе калибраторов давления Метран-517 или Метран-520;
- рабочего эталона для поверки и калибровки средств измерений давления кислородного исполнения (опция «Обезжиривание»);
- рабочего эталона давления при работе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок с маркировкой 1ExialIBT4X (опция взрывозащищенное исполнение, только с калибратором Метран-517-Ex).

### УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Модуль давления эталонный Метран-518. Модуль давления выполнен в виде малогабаритного устройства. Основными элементами модуля являются: прецизионный сенсор давления, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер и энергонезависимая память (EEPROM). В качестве сенсора в модулях давления D0,63K, D6,3K, D63K используется емкостная измерительная ячейка, в остальных модулях - тензопреобразователь. Микроконтроллер модуля давления обеспечивает непрерывное вычисление измеренного давления и температурную компенсацию в соответствии с функцией преобразования. Индивидуальные коэффициенты функции преобразования, полученные при калибровке модуля на предприятии-изготовителе, хранятся в энергонезависимой памяти модуля давления.

Модуль имеет встроенный асинхронный последовательный интерфейс, по которому он передает информацию об измеренном давлении в электронный блок калибратора давления (Метран-517 или Метран-520) или в персональный компьютер (см. схемы подключения рис. 1-3).

Модули давления обеспечивают измерение избыточного давления, абсолютного давления разрежения, давления разрежения и имеют множество исполнений по диапазону и погрешности измерений давления, что позволяет использовать их для поверки всех типов приборов давления.

Максимальное значение измеряемого давления 60 МПа. Минимальное значение давления-разрежения  $\pm 400$  Па.

Для генерации давления при поверке и калибровке используются пневматические и гидравлические источники создания давления (см. описание Источников создания давления). Все модули давления Метран-518 имеют в своей конструкции разделительную диафрагму (мембрану) из нержавеющей стали и обеспечивают работу, как с газообразными, так и жидкими средами, не вызывающими коррозию стали марки 12Х18Н10Т.

Модули давления изготавливаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении, а также с кодом исполнения «Обезжиривание». Маркировка взрывозащиты 1ExiaIIBT4X. Модули давления с кодом исполнения «Обезжиривание» предназначены только для поверки и калибровки СИД кислородного исполнения, не относятся к кислородному оборудованию и не предназначены для работы с газообразным кислородом и обогащенным кислородом воздухом.

**Внимание:** эксплуатация модулей давления Метран-518-Ex во взрывоопасных зонах допускается только совместно с калибраторами давления Метран-517-Ex. Схему подключения модулей Метран-518-Ex для взрывозащищенного применения см. раздел каталога "Калибратор давления Метран-517-Ex".

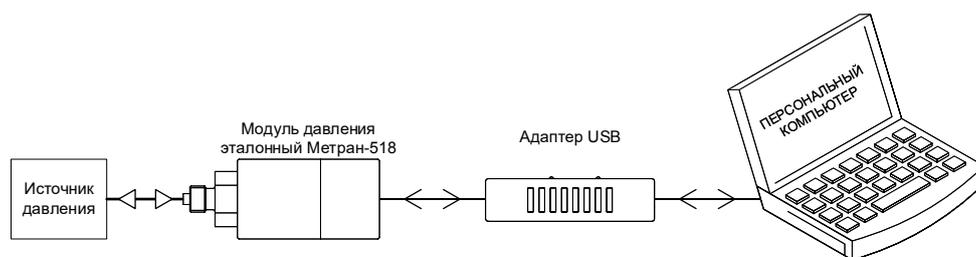


Рис. 1. Схема подключения модуля давления Метран-518 к компьютеру.

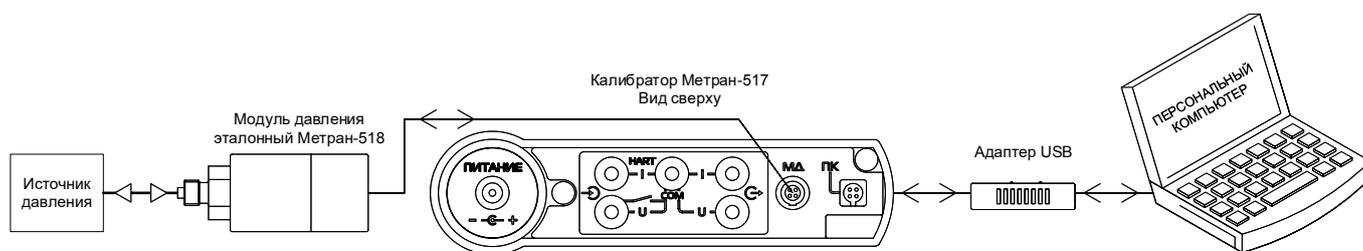


Рис. 2. Схема подключения модуля давления Метран-518 при работе в составе калибратора Метран-517.

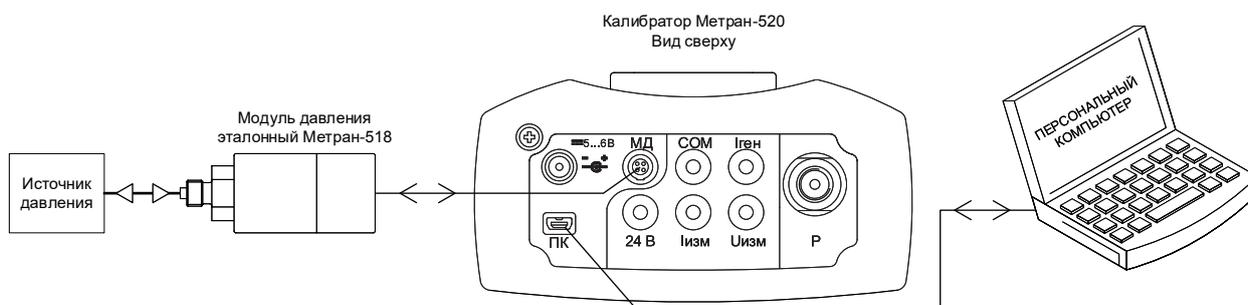


Рис. 3. Схема подключения модуля давления Метран-518 при работе в составе калибратора Метран-520.

**Режим работы с помощью компьютера**

Для управления работой модуля с помощью компьютера применяется Аппаратно-программный интерфейс для модулей Метран-518. Аппаратно-программный интерфейс - это комплект для оснащения одного рабочего места, включающий адаптер USB для подключения модуля давления к ПК и программное обеспечение «Поверка СИД».

Подключение модуля давления Метран-518 к адаптеру USB выполняется с помощью электрического кабеля с самозащелкивающимся разъемом из комплекта поставки аппаратно-программного интерфейса для эталонных модулей Метран-518.

Модуль давления при работе с помощью компьютера обеспечивает выполнение следующих функций:

- измерение давления и обеспечение связи с ПК по интерфейсу стандарта USB;
- проведение поверки, определение погрешности измерения давления ;
- формирование протокола поверки приборов давления в соответствии с соответствующими методиками поверки;
- корректировки показаний измеряемого давления (обнуление модулей);
- работа в режиме «Мониторинг давления» с сохранением измеренных модулем значений давления в течение заданного интервала времени;
- пользовательская калибровка модуля давления;

- хранение и передачу информации о модуле давления: код, диапазон, заводской номер, дату калибровки, предел допускаемой основной приведенной погрешности, количество зафиксированных перегрузок и дату последней зафиксированной перегрузки;
- хранение и передачу шестнадцати значений ВПИ и НПИ поверяемого прибора.

**Режим работы с помощью калибратора**

Выбор режимов работы и диапазонов измерений модуля проводится с помощью клавиатуры и дисплея калибраторов Метран-517 и Метран-520.

Модуль давления Метран-518 может применяться с любым электронным блоком калибратора Метран-517 или Метран-520, что позволяет заказчику расширять рабочий диапазон калибраторов и функциональные возможности комплекта для поверки и калибровки безотправки электронного блока калибратора изготовителю для перекалибровки.

Подключение модуля давления Метран-518 к калибратору Метран-517 или Метран-520 выполняется с помощью электрического кабеля с самозащелкивающимся разъемом из комплекта поставки калибраторов давления.

Особенности работы и функции модулей давления в составе комплекта калибраторов давления Метран-517 и Метран-520 см. соответствующие разделы данного каталога.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ**

**Диапазоны измерений давления**

**Таблица 1**

Код модуля давления	Диапазоны измерений модуля давления, МПа	Поддиапазоны измерений давления, МПа					Предельно-допускаемое давление, МПа
<b>Избыточное давление</b>							
2,5К	0-0,0025				0-0,0016	0-0,0025	0,0035
6,3К	0-0,0063				0-0,004	0-0,0063	0,0085
25К	0-0,025		0-0,01		0-0,016	0-0,025	0,035
160К	0-0,16	0-0,04	0-0,063		0-0,1	0-0,16	0,22
1М	0-1,0	0-0,25	0-0,4		0-0,63	0-1,0	1,4
6М	0-6,0	0-1,6	0-2,5		0-4,0	0-6,0	8
25М	0-25		0-10		0-16	0-25	35
60М	0-60				0-40	0-60	70
160М	0-160				0-100	0-160	180
<b>Избыточное давление, разрежение, давление-разрежение</b>							
D6,3К1	±0,0063		±0,00125	±0,002	±0,00315	±0,0063	0,009
		0-0,001	0-0,0016	0-0,0025	0-0,004	0-0,0063	
D63К1	±0,063		±0,0125	±0,02	±0,0315	±0,063	0,09
		0-0,01	0-0,016	0-0,025	0-0,04	0-0,063	
D160К	-0,1-0,15			±0,05	-0,1-0,06	-0,1-0,15	0,22
		0-0,16	0-0,04	0-0,063	0-0,1	0-0,16	
D1М	-0,1-0,9			-0,1-0,3	-0,1-0,53	-0,1-0,9	1,4
		0-1,0	0-0,25	0-0,4	0-0,63	0-1,0	
D2,5М	-0,1-2,4				-0,1-1,5	-0,1-2,4	3,5
		0-2,5			0-1,6	0-2,5	
<b>Абсолютное давление</b>							
A160К	0-0,16	0-0,025	0-0,04	0-0,06	0-0,1	0-0,16	0,22
A1М	0-1,0		0-0,25	0-0,4	0-0,6	0-1	1,4
A6М	0-6,0		0-1,6	0-2,5	0-4,0	0-6,0	8

Примечания:

1. Для обеспечения минимальной погрешности поверки (калибровки) диапазон измерений каждого сменного эталонного модуля разбит на 2-12 поддиапазонов (в зависимости от модуля), при этом допускаемая основная приведенная погрешность измерения давления нормируется от выбранного поддиапазона измерений.

2. Для всех модулей возможен ввод пользователем нестандартных диапазонов в пределах работы модуля, но для нормирования погрешности модуля будет выбираться его ближайший (более широкий) стандартный поддиапазон.

3. Модули Метран-518 с кодами D6,3К1 и D63К1 являются модернизированным исполнением модулей Метран-518 с кодами D6,3К и D63К (выпуск которых был прекращен в 2022 г.)

## Погрешности измерений давления

Таблица 2

Код модуля давления	Диапазоны измерений модуля давления, МПа	Минимальный поддиапазон <sup>1)</sup> измерений модуля, МПа	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности $\gamma$ % поддиапазона измерений модуля <sup>1)</sup> , не более (A-G-коды погрешностей)							
			A	B	C	D	E	F	G	
<b>Модули избыточного давления/ давления-разрежения</b>										
2,5K	0-0,0025	0-0,0016					±0,04%	±0,05%	±0,06%	±0,1%
6,3K	0-0,0063	0-0,004								
25K	0-0,025	0-0,01			±0,03%	±0,04%	±0,05%	±0,06%		
160K	0-0,16	0-0,04								
1M	0-1,0	0-0,25	±0,02%	±0,025%	±0,03%	±0,04%	±0,05%	±0,06%		
6M	0-6,0	0-1,6								
25M	0-25	0-10								
60M	0-60	0-40								
160M	0-160	0-100		±0,025%	±0,03%	±0,04%	±0,05%	±0,06%		
<b>Модули избыточного давления, разрежения, давления-разрежения<sup>2)</sup></b>										
D6,3K1	±0,0063	0-0,001					±0,04% (±0,05%) <sup>2)</sup>	±0,05% (±0,06%) <sup>2)</sup>	±0,06% (±0,1%) <sup>2)</sup>	±0,1% (±0,15%) <sup>2)</sup>
D63K1	±0,063	0-0,01	±0,02%	±0,025%	±0,03%	±0,04%	±0,05%	±0,06%		
D160K	-0,1-0,15 0-0,16	0-0,04								
D1M	-0,1-0,9 0-1,0	0-0,25								
D2,5M	-0,1-2,4 0-2,5	0-1,6								
<b>Модули абсолютного давления</b>										
A160K	0-0,16	0-0,025		±0,025% 3), 4)	±0,03% 3), 4)	±0,04% 3)	±0,05% 3)	±0,06%	±0,1%	
A1M	0-1,0	0-0,25		±0,025%	±0,03%	±0,04%	±0,05%	±0,06%	±0,1%	
A6M	0-6,0	0-1,6								

<sup>1)</sup> Все поддиапазоны модулей указаны в табл. 1.

<sup>2)</sup> Погрешность в поддиапазонах избыточного давления указана без скобок, в скобках указана погрешность в поддиапазонах давления-разрежения.

<sup>3)</sup> Погрешность ±0,06% в поддиапазоне 0-25 кПа.

<sup>4)</sup> Погрешность ±0,04% в поддиапазоне 0-40 кПа.

Примечание: основная погрешность измерений давления включает нелинейность, вариацию и повторяемость.

**Пределы допускаемой дополнительной погрешности**, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от температуры (20±2)°C на каждые 10°C, %: ±0,5 $\gamma$

**Степень защиты от воздействия пыли и влаги:** IP54

**Масса модуля давления**

- на основе тензопреобразователя не более 0,5 кг;

- на основе емкостной измерительной ячейки не более 1,5 кг.

**Средний срок службы** не менее 8 лет.

**Питание** модуля от электронного блока калибратора давления (Метран-517 или Метран-520) или от адаптера USB от ПК.

**Мощность**, потребляемая модулем давления, не более 0,05 Вт.

**ПОВЕРКА**

Периодичность поверки - 1 раз в год.

Госповерка в качестве эталона в соответствии с МИ 1595.200.00 "Модуль давления эталонный Метран-518"

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура окружающего воздуха от 0 до 50°C.

Относительная влажность от 30 до 80% при 25°C.

Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты изготовления, в зависимости от того, какой из данных периодов истекает раньше.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС**

АО "ПГ "Метран" осуществляет следующие виды работ:

- Профилактические работы:
  - проверка герметичности, работоспособности;
  - устранение дефектов;
  - определение метрологических характеристик.
- Средний или сложный ремонт в короткие сроки.
- Калибровка модулей давления, погрешность которых больше допускаемой основной погрешности.
- Поверка.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
МОДУЛЯ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-518**

- модуль давления Метран-518	1 шт.
- паспорт	1 экз.*
- руководство по эксплуатации	1 экз.*
- свидетельство о поверке	1 экз.
- методика поверки	1 экз.*
- опции	по заказу

\* – 1 экземпляр на каждые 3 модуля в заказе.

**ОПЦИИ**

1. Аппаратно-программный интерфейс для Метран-518<sup>1)</sup>.
2. "Обезжиривание". Модули давления калибратора с кодом исполнения "Обезжиривание" предназначены только для поверки и калибровки приборов кислородного исполнения. Перед работой они проходят операцию обезжиривания. Для работы с обезжиренными модулями давления рекомендуется применять пресс П-70К, предназначенный для работы с кислородными приборами. Рабочая среда пресса П-70К-дистиллированная вода по ГОСТ 6709. Код опции в строке заказа – «О».
3. Кабель для подключения модуля давления к калибратору или адаптеру USB

4. Штуцеры переходные, быстросъемные соединения, стойки, коллекторы для подключения поверяемых датчиков с различными резьбами к источнику создания давления, стойки, коллекторы и др.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> В комплект поставки входит адаптер USB, кабель для подключения модуля давления к ПК, программное обеспечение «Поверка СИД» (описание см. в разделе программное обеспечение «Поверка СИД»). Для заказа аппаратно-программного интерфейса для Метран-518 следует указать только заводской номер (модуль остается у пользователя).

<sup>2)</sup> Информацию см. в разделах "Быстросъемное соединение БС-70", "Средства коммутации и установки приборов, ЗИП".

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭТАЛОННОГО МОДУЛЯ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-518 ПРИ ЗАКАЗЕ**

- ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** Метран-518 - D6,3К - E  
 1 2 3
- ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** Метран-518 - A1M - E - Ex  
 1 2 3 4
- ПОВЕРКА КИСЛОРОДНЫХ ПРИБОРОВ:** Метран-518 - 25M - E - O  
 1 2 3 4

**Аппаратно-программный интерфейс для Метран-518**

1. Наименование и модель модуля давления.
2. Код модуля давления по диапазону измерений (см.табл.1).
3. Код модуля давления по пределу допускаемой основной погрешности (см.табл.2).
4. Код исполнения модуля давления: отсутствие обозначения (общепромышленное исполнение) или Ex (для применения во взрывоопасной зоне использовать только с калибратором Метран-517-Ex) или "O" (см.опцию "Обезжиривание").

**Примечания:**

1. Каждый модуль давления указывается в отдельной строке.
2. Опции указываются при заказе в отдельных строках:  
 - аппаратно-программный интерфейс для Метран-518 для работы модуля с ПК без калибратора. Состав интерфейса: адаптер USB, кабели для подключения модуля к ПК, программное обеспечение "Поверка СИД". Один интерфейс для любого количества модулей Метран-518 (описание см. в разделе программное обеспечение "Поверка СИД"); При заказе опции отдельно от модуля следует указать только заводской номер Метран-518 (модули остаются у пользователя);  
 - источники давления, штуцеры переходные и т.д. Примеры обозначения при заказе см. соответствующие разделы данного каталога.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ**

**Таблица 4**

Модель источника	Код модуля давления																
	2,5К	6,3К	25К	160К	1М	6М	25М	60М	160М <sup>4)</sup>	D6,3К1	D63К1	D160К	D1М	D2,5М	A160К	A1М	A6М
П-0,04 <sup>1)</sup>	●	●	●							●							
П-0,25М <sup>1)</sup>	●	●	●	●						●	●	●			●		
Н-2,5М <sup>1)</sup>		●	●	●	●	● <sup>3)</sup>											
Н-2,5УМ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	● <sup>3)</sup>				●	●	●	●	●	●	●	● <sup>3)</sup>
П-70 <sup>1)</sup>					●	● <sup>3)</sup>	●	●									
П-70К <sup>2)</sup>				●	●	● <sup>3)</sup>	●	●									

<sup>1)</sup> Источники давления поставляемые при заказе взрывозащищенного исполнения модулей давления или калибратора.  
<sup>2)</sup> Пресс П-70-К рекомендуется для работы с модулями давления Метран-518 (160К, 1М, 6М, 25М, 60М с кодом "O" - обезжиривание).  
<sup>3)</sup> В диапазоне до 2,5 МПа – Н-2,5УМ, Н-2,5М, в диапазоне более 2,5 МПа – П-70, П-70-К.  
<sup>4)</sup> Применяются источники высокого давления сторонних производителей.

Информацию о перечисленных источниках давления см. в соответствующем разделе данного каталога.

**Вниманию заказчиков!** Поверяемые приборы и эталонные модули давления с диапазоном измерений до 25 кПа чувствительны к давлению перегрузки и их метрологические характеристики после воздействия давления  $P_{вх} > P_{доп}$  (см. табл.1) могут ухудшиться. При использовании источников создания давления, например, ручного насоса Н-2,5М и т.п., возможно одним резким нажатием рычагов насоса превысить предельно-допускаемое значение. Помпы П-0,04, П-0,25М это исключают.

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и присоединительные размеры модулей давления зависят от исполнения (общепромышленное (стандартное или с опцией «Обезжиривание»), взрывозащищенное) а также кода модели модуля Метран-518.

Таблица 5

Код модулей давления	Резьба присоединительного штуцера						
	A	B	C	D	E	F	G
2,5K	-	-	-	M12×1,5 / рис. 4 а) / рис. 5 а) / рис. 5 б)			
6,3K	-	-	-	M12×1,5 / рис. 4 а) / рис. 5 а) / рис. 5 б)			
25K	-	-	M12×1,5 / рис. 4 а) / рис. 5 а) / рис. 5 б)				-
160K	M12×1,5 / рис. 4 б) / рис. 5 б) или M20×1,5* / рис. 4 в) / рис. 5 в)			M12×1,5 / рис. 4 б) / рис. 5 б)			-
1M							-
6M							-
25M							-
60M							-
160M	M20×1,5 / рис. 4 в) / рис. 5 в)						-
D6,3K1	-	-	-	M12×1,5 / рис. 4 б) / рис. 5 б)			
D63K1	M12×1,5 / рис. 4 б) / рис. 5 б)						-
D160K	M12×1,5 / рис. 4 б) / рис. 5 б) или M20×1,5* / рис. 4 в) / рис. 5 в)			M12×1,5 / Рис. 4 б) / рис. 5 б)			-
D1M							-
D2,5M							-
A160K							-
A1M	M12×1,5 / рис. 4 б) / рис. 5 б) или M20×1,5* / рис. 4 в) / рис. 5 в)						-
A6M	-	M12×1,5 / рис. 4 б) / рис. 5 б) или M20×1,5* / рис. 4 в) / рис. 5 в)					

\* Для модулей давления Метран-518, выпущенных до 2023 г. Источники создания давления производства ПГ «Метран» (пневматические насосы, помпы, гидравлические прессы), имеют выходные порты или включают в комплект поставки переходные штуцеры для подключения модулей давления как с резьбой M12×1,5 так и M20×1,5. Для подключения модулей давления, выпущенных после 2023 г., к источникам создания давления стороннего производства с присоединительной резьбой M20×1,5 рекомендуется использовать «Штуцер переходной № 25».

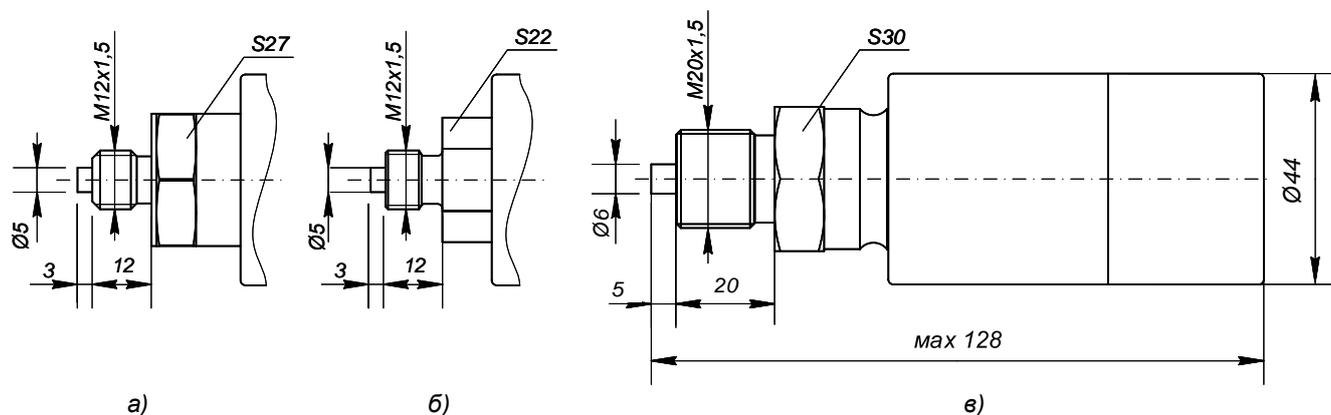


Рис. 4. Модуль давления общепромышленного исполнения.

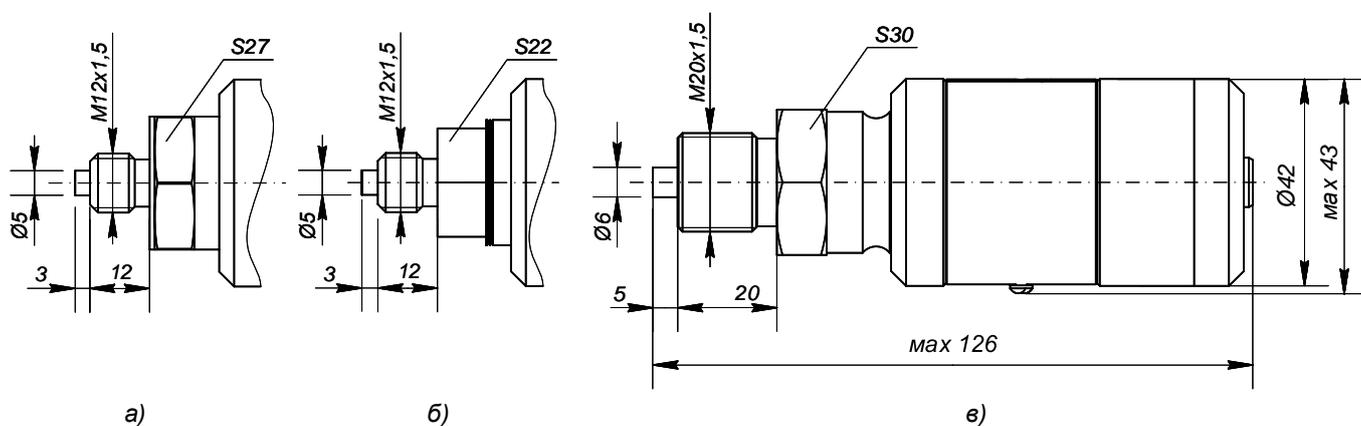


Рис. 5. Модуль давления взрывозащищенного исполнения или общепромышленного с кодом опции «Обезжиривание».

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ПОВЕРКА СИД»

Программное обеспечение «Поверка СИД» - универсальное. Оно работает со всеми калибраторами давления серии Метран, контроллерами давления РРС3/4, Метран-530, модулями давления, мультиметрами Метран-514 и Agilent 30401A. Описание см. в разделе Программное обеспечение «Поверка СИД».

## АО «ПГ «Метран»

Россия, 454103, г. Челябинск  
Новоградский проспект, 15  
т. +7 (351) 24-24-444  
info@metran.ru  
www.metran.ru

Технические консультации  
по выбору средств измерений  
т. +7 (351) 24-24-000  
support@metran.ru

Сервис средств измерений  
Вопросы послепродажного обслуживания  
т. 8-800-200-16-55  
service@metran.ru

Поддержка по соленоидным клапанам  
и фильтр-регуляторам  
Заказ и подбор, техническая поддержка  
т. +7 (351) 242-41-36 – Урал, Сибирь  
т. +7 (499) 403-62-89 – Москва  
т. +7 (812) 648-11-56 – Санкт-Петербург  
asco@metran.ru

## ООО «Метран Проект»

Россия, 454103, г. Челябинск  
Новоградский проспект, 15  
т. +7 (351) 240-88-82  
Поддержка по аналитическому  
оборудованию, беспроводным решениям,  
проектам и сервису систем управления  
Info@metran-project.ru

## ООО «Метран Контролс»

Россия, 454103, г. Челябинск  
Новоградский проспект, 15  
т. +7 (351) 277-97-15  
Поддержка по регулирующему  
оборудованию и сервису ЗРА  
Info@metran-controls.ru

## ООО «КМС»

Россия, 454103, г. Челябинск  
Новоградский проспект, 15  
Поддержка по метрологическим стандам  
т. +7 (912) 306-64-00  
tdn@kmscompany.ru

Прием заказов на продукцию осуществляется через региональные представительства.

## Региональные представительства

### Екатеринбург

620100, Сибирский тракт, 12  
строение 1А, офис 224  
т. +7 (351) 24-24-149, 24-24-139  
66@metran.ru

### Казань

420107, ул. Островского, 87, офис 310  
т. +7 (351) 24-24-160  
16@metran.ru

### Красноярск

660000, ул. Ладо Кецховели, 22а, офис 11-04  
т. +7 (351) 24-24-034, 24-24-033  
24@metran.ru

### Москва

Россия, 115054, г. Москва  
ул. Дубининская, 53, стр. 5  
т. +7 (499) 403-6-403  
77@metran.ru

### Нижнекамск

423579, пр. Вахитова, 23  
т. +7 (351) 24-24-037  
16-8555@metran.ru

### Нижний Новгород

603006, ул. Горького, 117, офис 905  
т. +7 (351) 24-24-047  
52@metran.ru

### Новосибирск

630132, ул. Железнодорожная, 15/2  
БЦ «Джет», офис 410  
т. +7 (351) 24-24-055, 24-24-057, 24-24-053  
54@metran.ru

### Пермь

614007, Николая Островского, 59/1  
БЦ «Парус», этаж 11, офис 1103  
т. +7 (351) 24-24-062  
59@metran.ru

### Ростов-на-Дону

344113, пр. Космонавтов, 32В/21В, офис 402  
т. +7 (351) 24-24-146  
61@metran.ru

### Самара

443041, ул. Л. Толстого, 123Р, корпус В,  
этаж 5, офис 501  
т. +7 (351) 24-24-070  
63@metran.ru

### Санкт-Петербург

197374, ул. Торфяная дорога, 7, лит. Ф,  
этаж 12, офис 1221  
т. +7 (812) 648-11-29  
47@metran.ru

### Тюмень

625048, ул. М. Горького, 76  
этаж 3, офис 307  
т. +7 (351) 24-24-088, 24-24-090, 24-24-147  
72@metran.ru

### Уфа

450057, ул. Ленина, 70, БЦ «Гарда»  
этаж 5, офис 70  
т. +7 (351) 24-24-169  
02@metran.ru

### Хабаровск

680000, ул. Истомина, 51а  
БЦ «Капитал», офис 205, 206  
т. +7 (351) 24-24-178  
27@metran.ru

### Челябинск

454003, Новоградский проспект, 15  
т. +7 (351) 24-24-584, 24-24-149, 24-24-139  
74@metran.ru

### Южно-Сахалинск

693020, ул. Курильская, 40, этаж 3, офис 11  
т. +7 (351) 24-24-186  
65@metran.ru

### Беларусь, Минск

т. +375 29 8608608  
minsk@metran.ru

 vk.com/metranru

 t.me/metranru

 youtube.com/@metran\_ru

 dzen.ru/metran



Новости автоматизации,  
новые продукты,  
технологии производства  
в нашем телеграм-канале

Реквизиты актуальны на момент выпуска каталога. Уточнить их Вы можете на сайте [www.metran.ru](http://www.metran.ru)

©2024. Все права защищены.

Правообладателем товарного знака «Группа компаний Метран» является ООО «Метран Холдинг». Правообладателем товарного знака «Метран» является АО «ПГ «Метран». Содержание данного документа можно использовать только для ознакомления. Несмотря на то, что содержащиеся в данном документе сведения тщательно проверяются, они не являются гарантией, явной или подразумеваемой, относительно описанных в данном руководстве изделий или услуг, а также относительно возможности их применения. Положения и условия продажи определяются компанией и предоставляются по требованию. Мы сохраняем за собой право на изменение и дополнение конструкций и технических условий наших изделий без уведомления и в любое время.

Редакция 02/2024

 ГРУППА КОМПАНИЙ  
**МЕТРАН**